


Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ**Kính gửi:**

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đang triển khai xây dựng giá kế hoạch gói thầu “**Đổ mực máy in laser đen trắng**”. Để có cơ sở xây dựng giá kế hoạch, Viện mong muốn Quý công ty gửi bản báo giá với các nội dung công việc và yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như sau:

TT	Tên hạng mục	Đơn vị tính	Số lượng	Tính năng kỹ thuật	Yêu cầu chung
1.	Đổ mực máy in laser đen trắng: <i>Gồm các loại máy in hiện có tại Viện:</i> - HP 2035, - HP 2055, - HP 401, - Canon 251, - Canon 252, - Canon 6670, - Canon 2900,	chai	9.320	<ul style="list-style-type: none">➤ Trọng lượng tịnh của mực đổ: $\geq 140\text{g}/01$ chai.➤ Số lượng bản in cho mỗi lần đổ mực: ≥ 2.000 trang A4 (với độ phủ 5%).➤ .Bản in rõ chữ, sạch sẽ, không nhoè, không lem bản.	<ul style="list-style-type: none">- Chai mực mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng- Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp cartridge để đổ mực phù hợp với các máy in theo yêu cầu của bên mời thầu. Các chi phí phát sinh liên quan đến việc thay thế các linh kiện trong cartridge do nhà thầu chịu trách nhiệm.- Cam kết hỗ trợ bệnh viện vệ sinh máy in 02 lần/năm.- Cam kết thu hồi và thay thế hàng hoá không đủ tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu đã đưa ra của bên mời thầu.- Thời gian đến bệnh viện đổ mực không quá 30 phút kể từ khi
2.	Đổ mực máy in laser đen trắng: <i>Gồm loại máy in hiện có tại Viện:</i> - HP 501	chai	1.440	<ul style="list-style-type: none">➤ Trọng lượng tịnh của mực đổ: $\geq 140\text{g}/01$ chai.➤ Số lượng bản in cho mỗi lần đổ mực: ≥ 6.000 trang A4 (với độ phủ 5%).➤ Bản in rõ chữ, sạch sẽ, không nhoè, không lem bản.	



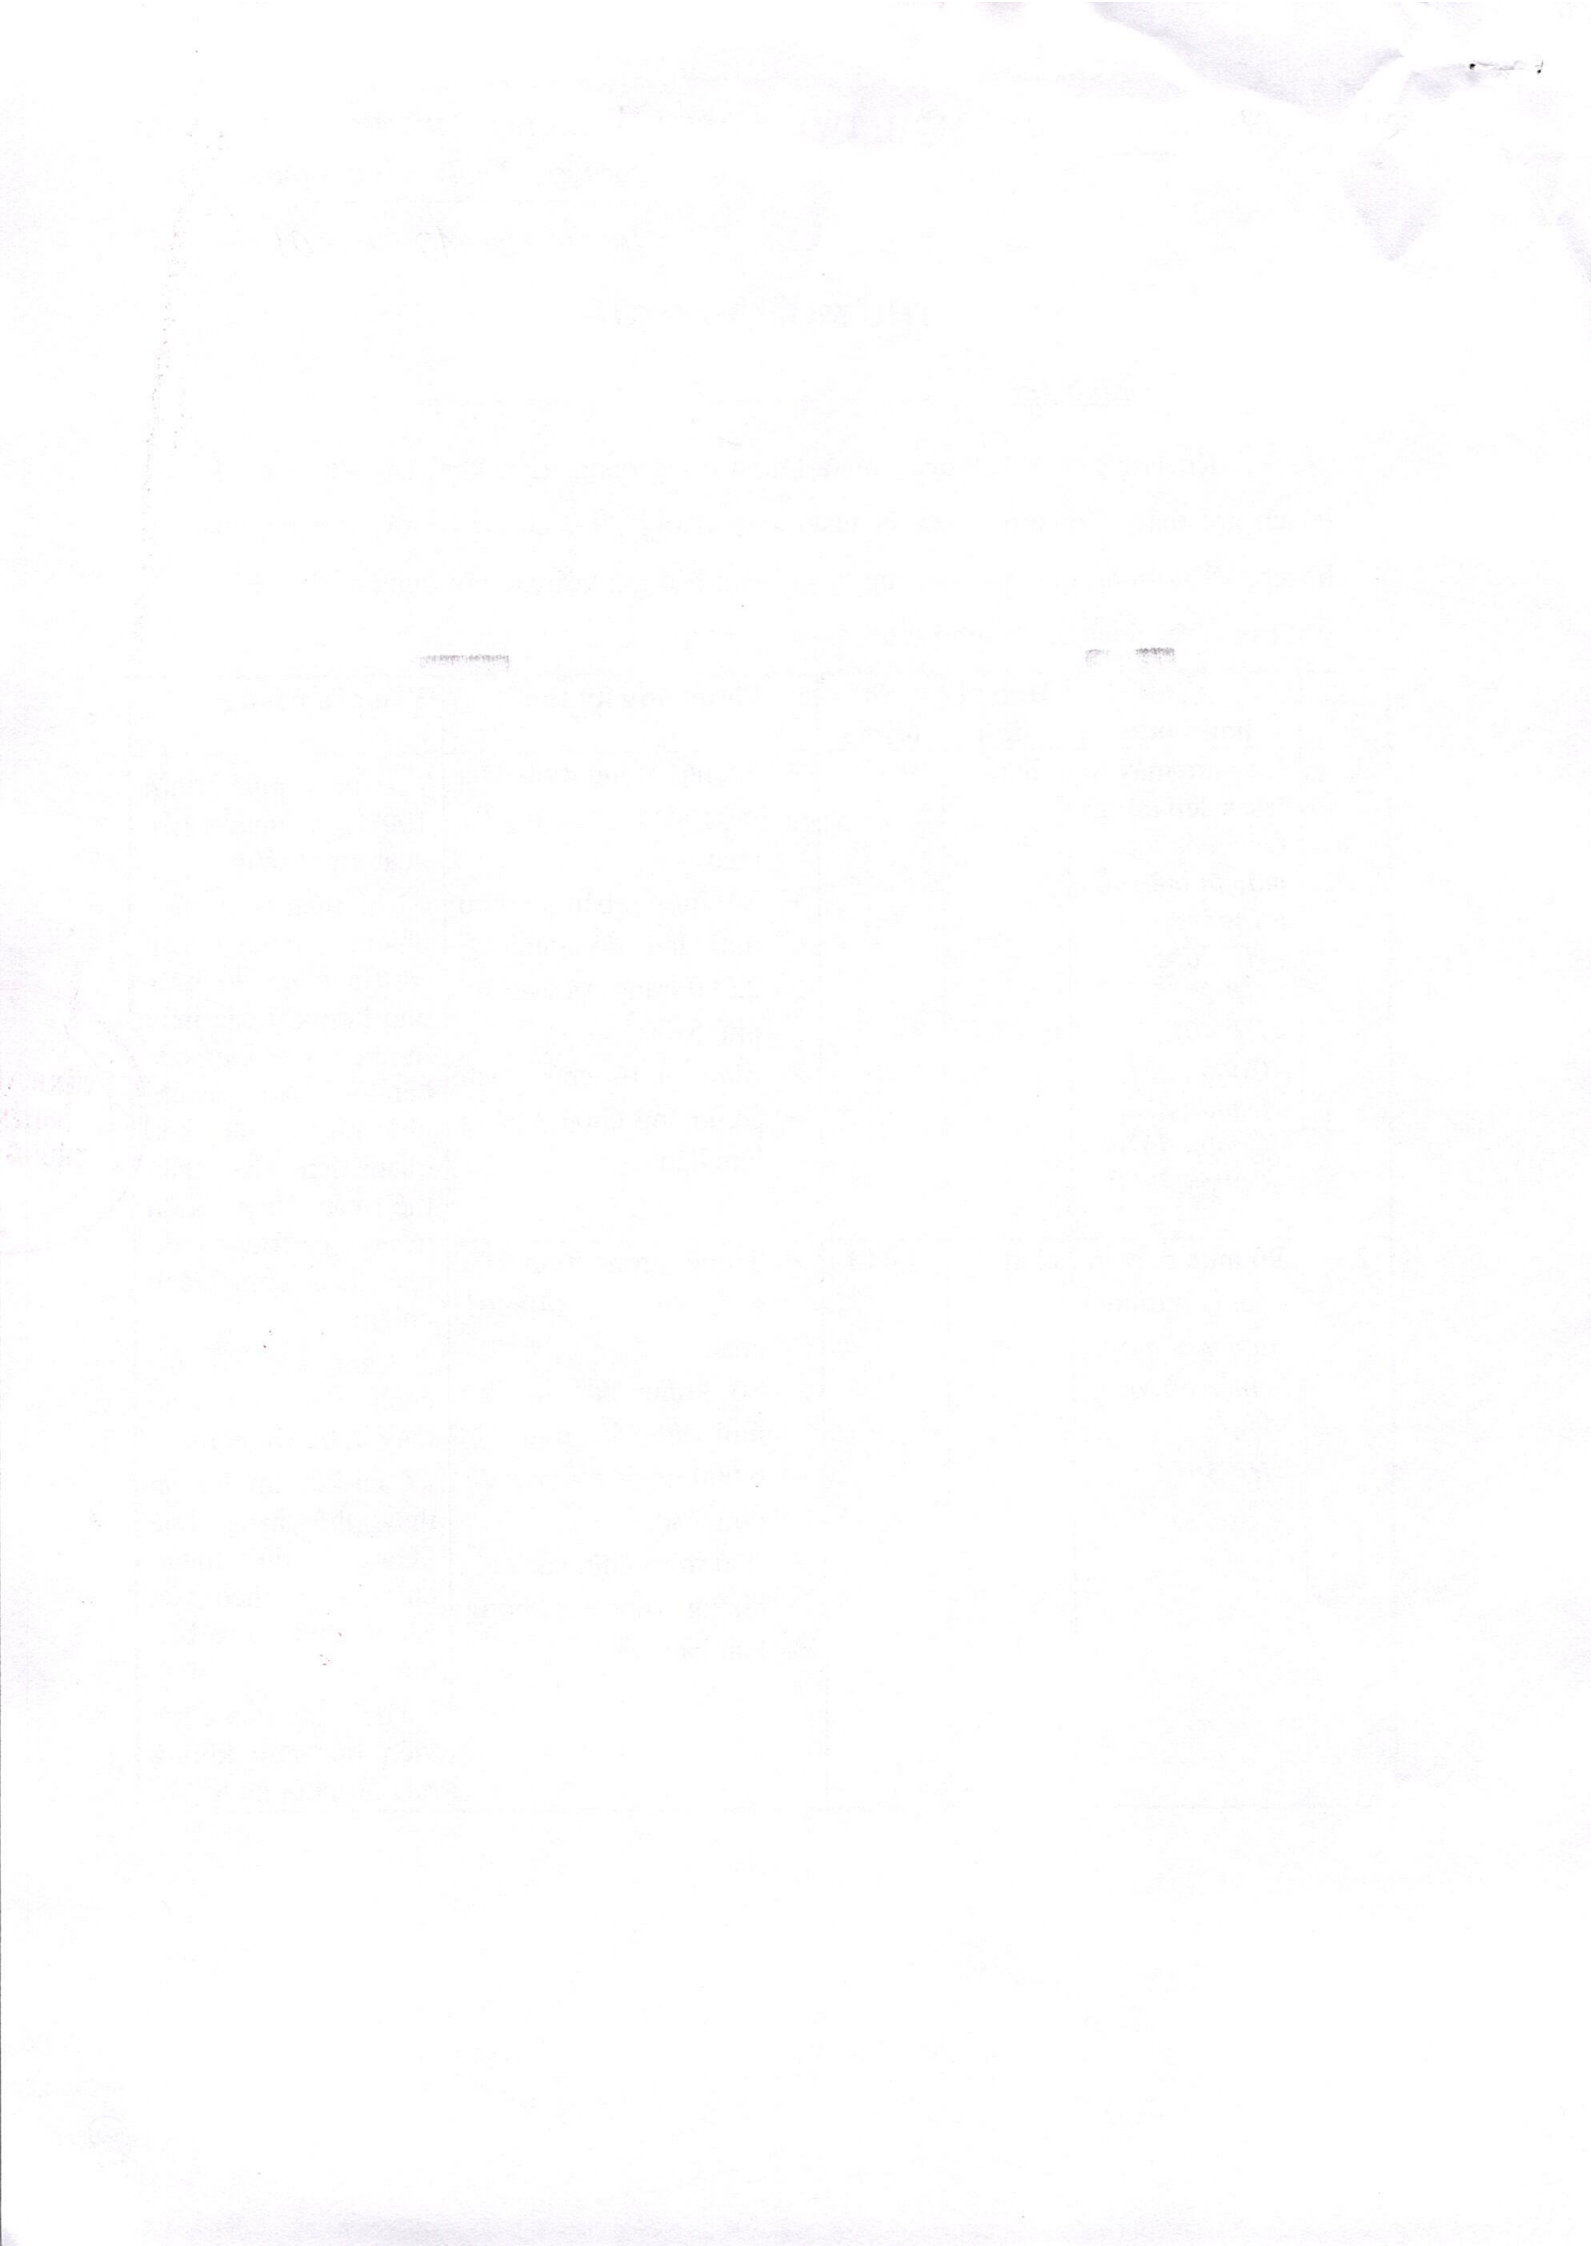

TT	Tên hạng mục	Đơn vị tính	Số lượng	Tính năng kỹ thuật	Yêu cầu chung
3.	Đồ mực máy in laser đen trắng: <i>Gồm loại máy in hiện có tại Viện:</i> - Ricoh SP230	chai	240	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Trọng lượng tịnh của mực đổ: $\geq 80g/01$ chai. ➤ Số lượng bản in cho mỗi lần đổ mực: ≥ 2.000 trang A4 (với độ phủ 5%). ➤ Bản in rõ chữ, sạch sẽ, không nhoè, không lem bản. 	nhận được yêu cầu từ phía bệnh viện. - Yêu cầu cartridge mực in bảo đảm giới hạn hàm lượng hóa chất độc hại theo quy định tại Thông tư 30/2011/TT-BCT ngày 10/8/2011 của Bộ Công Thương

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương kính mời Quý công ty quan tâm đến gói thầu “**Đồ mực máy in laser đen trắng**” với các yêu cầu nêu trên. Quý công ty cần tìm hiểu thêm thông tin xin mời liên hệ:

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG

Đường Phạm Văn Bạch – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: 0243 7 821 895 máy lẻ 222 hoặc 226 Fax: 0243 8 685 582

Bản chào giá của Quý công ty bao gồm:

1. Bản chào giá theo số lượng và yêu cầu kỹ thuật của Viện.
2. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh có đóng dấu của đơn vị.
3. Hiệu lực của báo giá tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày ký báo giá.

Bản chào giá của Quý công ty chuyển đến số phòng 132, Phòng Văn thư, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trước 9h00 ngày 17 tháng 01 năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

VIỆN HUYẾT HỌC
TRUYỀN MÁU
TRUNG ƯƠNG

* Lê Lâm

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

