

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ**Kính gửi:**

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đang triển khai xây dựng giá kế hoạch gói thầu “**Cung cấp Đồ điện tử, điện lạnh**”. Để có cơ sở xây dựng giá kế hoạch, Viện mong muốn Quý công ty gửi bản báo giá với các nội dung công việc và yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như sau:

TT	Tên hạng mục	ĐVT	Số lượng
1.	Ổ cắm điện: <ul style="list-style-type: none"> Chiều dài dây dẫn: 3m Số ổ cắm đa năng: 6 ổ (có nắp che an toàn) Công suất chịu tải: $\geq 10A - 2200W$ Số công tắc an toàn: ≥ 02 Chất liệu vỏ nhựa ABS Số lõi dây: 02, sử dụng đồng nguyên chất. Có role bảo vệ quá tải, chập tải. 	Chiếc	40
2.	Ổ cắm điện: <ul style="list-style-type: none"> Chiều dài dây dẫn: 5m Số ổ cắm đa năng: 6 ổ (có nắp che an toàn) Công suất chịu tải: $\geq 10A - 2200W$ Số công tắc an toàn: ≥ 02 Chất liệu vỏ nhựa ABS Số lõi dây: 02, sử dụng đồng nguyên chất. Có role bảo vệ quá tải, chập tải. 	Chiếc	65
3.	Ổ cắm điện dạng cuộn: <ul style="list-style-type: none"> Chiều dài dây dẫn: 20m Số ổ cắm đa năng: ≥ 3 ổ (có nắp che an toàn) Công suất chịu tải: $\geq 15A$ Số công tắc an toàn: ≥ 01 Chất liệu vỏ nhựa ABS Số lõi dây: 02, sử dụng đồng nguyên chất. Có role bảo vệ quá tải, chập tải. 	Chiếc	14
4.	Quạt trần: <ul style="list-style-type: none"> Đường kính cánh: 1400mm (± 30mm) Công suất: $\geq 75W$ Chất liệu cánh quạt: 3 cánh bằng Sắt hoặc nhôm Điều chỉnh bằng nút vận hành số 5 tốc độ. Lưu lượng gió: $\geq 250 m^3/phút$ Bảo hành ≥ 12 tháng 	Chiếc	07

TT	Tên hạng mục	ĐVT	Số lượng
5.	Quạt đảo trần: <ul style="list-style-type: none"> • Đường kính sai cánh: $\geq 400\text{mm}$ • Công suất: $\geq 46\text{W}$ • Chất liệu cánh quạt: Nhựa • Điều khiển từ xa, 3 tốc độ gió. • Lưu lượng gió: $\geq 77 \text{ m}^3/\text{phút}$ • Bảo hành ≥ 12 tháng 	Chiếc	51
6.	Quạt cây: <ul style="list-style-type: none"> • Đường kính sai cánh: $\geq 450\text{mm}$ • Công suất: $\geq 50\text{W}$ • Chất liệu cánh quạt: Nhựa • Điều chỉnh bằng núm vặn, 3 tốc độ gió. • Lưu lượng gió: $\geq 67 \text{ m}^3/\text{phút}$ • Kích thước: Đường kính x Cao: $50\text{cm} \times 110\text{cm}$ • Bảo hành ≥ 12 tháng 	Chiếc	07
7.	Quạt hộp vuông: <ul style="list-style-type: none"> • Đường kính sai cánh: $\geq 350\text{mm}$ • Công suất: $\geq 55\text{W}$ • Chất liệu cánh quạt: Nhựa • Điều chỉnh bằng nút ấn, 3 tốc độ gió. • Bảo hành ≥ 12 tháng 	Chiếc	05
8.	Quạt treo tường: <ul style="list-style-type: none"> • Đường kính sai cánh: $\geq 400\text{mm}$ • Công suất: $\geq 46\text{W}$ • Chất liệu cánh quạt: Nhựa • Điều khiển bằng 2 dây giạt (1 dây điều chỉnh tốc độ, 1 dây điều chỉnh chế độ xoay) và nút vặn trên thân quạt, 3 tốc độ gió. • Lưu lượng gió: $\geq 77 \text{ m}^3/\text{phút}$ • Bảo hành ≥ 12 tháng 	Chiếc	07
9.	Quạt sàn công nghiệp: <ul style="list-style-type: none"> • Đường kính sai cánh: $\geq 400\text{mm}$, chất liệu nhôm sơn tĩnh điện. • Đường kính lồng quạt: $\geq 450\text{mm}$ • Công suất: $\geq 90\text{W}$ • Chất liệu: kim loại sơn tĩnh điện • 3 tốc độ gió, điều chỉnh bằng núm vặn trên thân quạt. • Bảo hành ≥ 12 tháng 	Chiếc	07
10.	Cây nước nóng lạnh: <ul style="list-style-type: none"> • Công suất làm lạnh: $\geq 100\text{W}$ • Công suất làm nóng: $\geq 500\text{W}$ • Bình chứa bằng Inox 304 • Nhiệt độ làm lạnh: $\leq 10^\circ\text{C}$ • Nhiệt độ làm nóng: $\geq 90^\circ\text{C}$ • Bảo hành ≥ 12 tháng 	Chiếc	09
11.	Tủ mát: <ul style="list-style-type: none"> • Thiết kế dạng đứng, 2 cửa, 4 bánh xe di chuyển • Công nghệ Inverter. • Tổng dung tích: $\geq 800\text{L}$ • Công suất: $\geq 400\text{W}$ • Chất liệu dàn lạnh: Đồng • Nhiệt độ làm lạnh: $0^\circ\text{C} - 10^\circ\text{C}$ • Bảo hành ≥ 24 tháng 	Chiếc	01

NHẬT H
 TRUẬN M
 TRUNG L
 *

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương kính mời Quý công ty quan tâm đến gói thầu “**Cung cấp Đồ điện tử, điện lạnh**” với các yêu cầu nêu trên. Quý công ty cần tìm hiểu thêm thông tin xin mời liên hệ:

PHÒNG QUẢN TRỊ

VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG

Đường Phạm Văn Bạch – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: 04 3 7 821 895 máy lẻ 683 hoặc 680

Fax: 0243 8 685 582


Bản chào giá của Quý công ty bao gồm:

- 1. Bản chào giá theo số lượng và yêu cầu kỹ thuật của Viện.*
- 2. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh có đóng dấu của đơn vị.*
- 3. Hiệu lực của báo giá tối thiểu là 04 tháng kể từ ngày ký báo giá.*

Bản chào giá của Quý công ty chuyển đến số phòng 132, Bộ phận Văn thư, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trước 14h00 ngày 12 tháng 5 năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

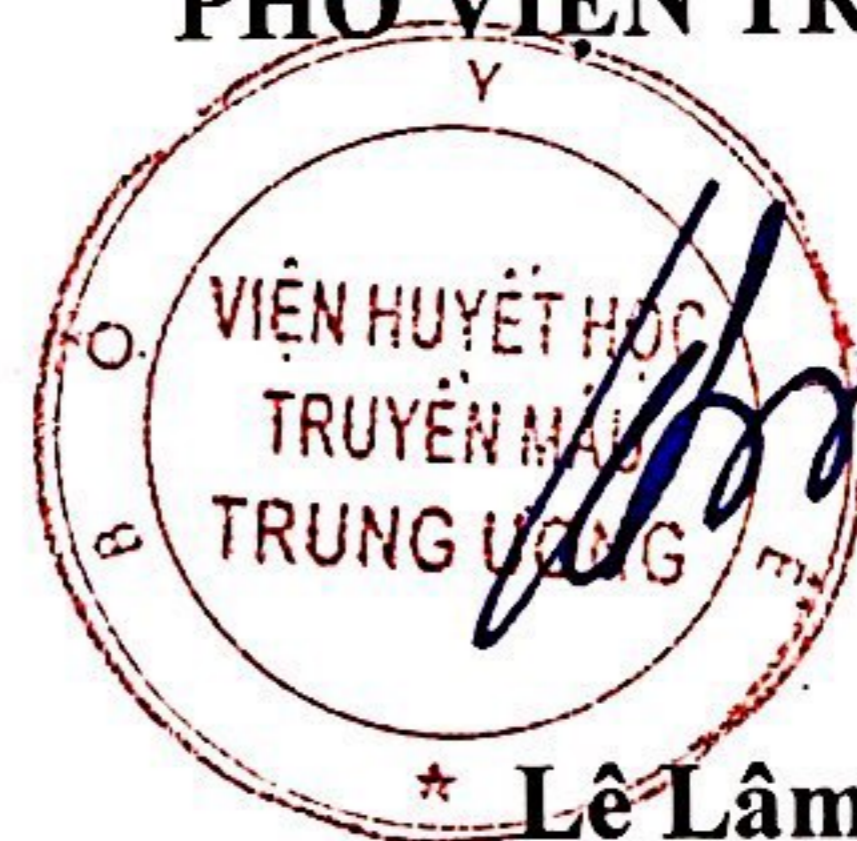

* Lê Lâm